
ВИЗУАЛЬНАЯ УШНАЯ БИРКА ДЛЯ КРС И ОЛЕНЕЙ

СИЛФЛЕКС® L2

“мама” - 80х60 мм,
“папа” - 60х60 мм

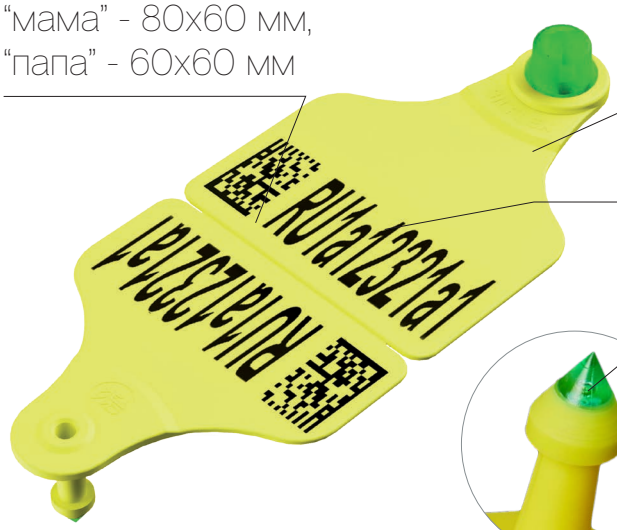

мягкий и эластичный материал, устойчивый к воздействию микробов и гидролиза

устойчивая маркировка

сверхострый поликарбонатный наконечник



камера усилена поликарбонатом и 3-мя жёсткими фиксаторами




- прочная фиксация на ухе и свободное вращение бирки
- яркие насыщенные цвета, нестираемая лазерная маркировка
- лёгкость прокола и быстрое заживление, препятствие развитию инфекций
- устойчивость к перепадам температуры от -55 до +55 °С
- простая утилизация, отсутствие металлических компонентов

СИЛФЛЕКС® L2

Уникальная конструкция наконечника и замковой камеры бирки **Силфлекс® L2** специально разработана для надёжного крепления и свободного вращения бирки. Сверхострый наконечник из морозостойкого поликарбоната обеспечивает лёгкость прокола и быстрое заживление. Мягкая эластичная бирка из полиуретана, устойчива к воздействию микробов и гидролиза, жестким погодным условиям и перепадам температур.
Не выгорает и не грубеет на морозе. Устойчивая лазерная маркировка любых форматов (номер, штрихкод, QR-код, логотип). Возможность нанесения уникального номера средства маркировки (УНСМ) + QR-код, эмитированного ФГБУ «ВНИИЗЖ», в рамках соглашения о сотрудничестве между Россельхознадзор и ООО «Силтэк».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	**полиуретан, замковая капсула и наконечник – поликарбонат**
Камера	**закрытая с тремя вентиляционными отверстиями**
Габаритный размер, мм	**мама: 80х60, папа: 60х60**
Поверхность бирки	**матовая**
Усилие замыкания, кгс	**до 25**
Максимальная сила разрыва	**280 Н**
Температура эксплуатации, °С	**от -55 до +55**
Постоянная маркировка	**логотип производителя, логотип продукта Silflex**
Переменная маркировка	**лазером, в соответствии с ISO 15416:2016 / либо без маркировки под специальный маркер**
Средства монтажа	**аппликатор/биркач/щипцы (рекомендуется использовать аппликатор производителя)**
Цвета	**желтый, красный, синий, зеленый, белый, розовый**
Группировка	**блок состоит из 4 бирок**
Количество в упаковке	**200 штук**

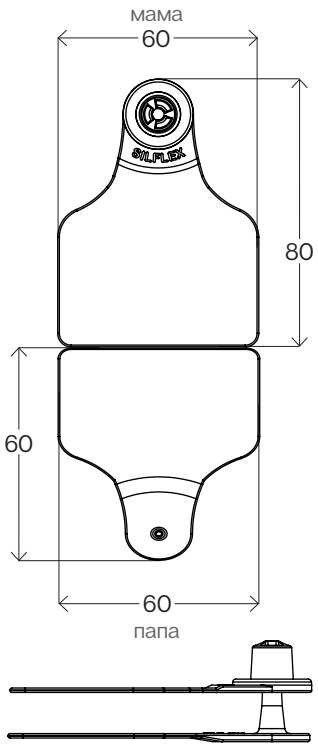

ИНСТРУКЦИЯ



1. Нажмите на рукоятки аппликатора и они автоматически разойдутся.



2. Нажмите на подпружиненную скрепку и установите часть «мама». Поместите часть «папа» полностью на игольчатый держатель.



3. Сожмите не до конца рукоятки для проверки совпадения частей бирки.



4. Опустите аппликатор с частями бирки в антисептический или дезинфецирующий раствор

5. Поместите аппликатор с бирками по центру ушка животного, между 2-м и 3-им хрящом, избегая попадания в кровеносные сосуды и опорные хрящи, и сожмите до упора и щелчка.

6. Разожмите кисть руки, аппликатор откроется и после этого удалите его с уха животного.

Внимание!
Запрещается силой срывать аппликатор с уха животного без предварительного разжатия.

